MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 08:45 horas del día 15 de mayo de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: DÑA. MARI CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: DÑA. MARIA VICTORIA LUQUE MORENO
Letrada de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia telemática)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIA: DÑA. ALICIA GUERRERO FUENTES
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.
   No se producen.

2. EXPEDIENTE AM 133/2026 SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09 ANALGESIA Y ANESTESIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTREGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAEN.

   2.1 Análisis del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica.

   En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

2.2 Si procede, acto de apertura del sobre electrónico nº3 de criterios de evaluación automáticos del expediente.

Por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura electrónica del sobre nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos, adjuntándose como Anexo II a este Acta.

2.3 Valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

La Mesa procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente conforme se detalla en el Anexo II a este Acta.

La Mesa de Contratación detecta que las ofertas presentadas para los lotes y licitadores señalados a continuación, se encuentra incursa en presunción de anormalidad según lo establecido en el apartado 7.3.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige dicha contratación, acordando requerir en el plazo de cinco días naturales a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, justifique y desglose razonada y detalladamente aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) *El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los suministro prestados o el método de construcción.*
b) *Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.*
c) *La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.*
d) *El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201.*
e) *O la posible obtención de una ayuda del Estado".*

Todo ello con el debido detalle que permita su adecuada valoración en orden a la exclusión o no de la clasificación de ofertas realizada, documentación que será elevada a la Comisión Técnica para su oportuna valoración en los términos establecidos en el art. 149.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El lote y licitador donde se ha detectado una oferta anormalmente baja es:

Lotes	Genérico de Centro (GC)	DENOMINACIÓN	Precio Unitario C/ IVA	Precio Unitario S /IVA	Empresa	Precio Ofertado S/Iva (Sobre Nº 3)	Precio Ofertado C/Iva (Sobre Nº 3)	% ANORMALIDAD
16	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];	1,344444	1,111100	**INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.**	0,4100 €	0,4961 €	**0,630999878**

2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

No procede.

2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El Acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:00 horas del 15 de mayo de 2026 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

V°. B°.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
Central Provincial de Compras de Jaén
Unidad de Contratación Administrativa
4.9

INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.19 MATERIAL ESPECÍFICO DE ANALGESIA Y ANESTESIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

Expediente: A.M. 133 /2026

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático sujetos a juicio de valor, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.-Composición de la Comisión Técnica Provincial

D. Alejandro Martínez García. FEA Anestesiología HMQ.

Dña. Leticia García Alemán. Supervisora HMI Jaén.

Dña. Sara Fernández Blanco. Supervisora Quirófano HSA.

Dña. Ana Márquez Sánchez. Jefa Servicio Anestesia y Reanimación del AGS Nordeste, Jaén.

Dña. Miriam Fernández Hornos. Subdirectora Enfermería HSJC.

D. Basilio Velasco Sánchez. FEA Cirugía Pediátrica HMI.

A continuación, se detallan **las Empresas que concurren , Agrupaciones y Lotes a los que licitan**:

EMPRESAS	AGRUPACIÓN	LOTES
AMEBIL S.L.	S.A.	20.
B.BRAUN MEDICAL S.A.	S.A.	19, 20, 22, 26.
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1 S.A.	(del 1 al 5). 7, 8, 9.
BECTON DICKINSON, S.A.U.	1 S.A.	(del 1 al 5). 9, 11, 12.
CARDIVA 2 S.L.	S.A. 2	9, 10, 13. (del 23 al 25).
IBERIAN CARE 2016 S.L.	S.A.	20.
ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L.	1 S.A.	(del 1 al 5). 7, 8, 20, 21, 26.
INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	S.A.	14, 16, 26.
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS S.L.U.	S.A.	9
MBA INCORPORADO S.L.	S.A.	20, 22.
SOL MILLENIUMN ESPAÑA	1	(del 1 al 5).
TELIC S.A.U.	S.A.	14, 15.
VIALTA S.L.	S.A.	13, 14, 15, 16.
VIGON S.A.U.	1 S.A.	(del 1 al 5). 10, 20, 22.

A continuación, se detallan las **Empresas, Agrupaciones y Lotes que No se Valoran**, y causas que lo motivan.

EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1	1, 3	Los lotes 2 ,4 y 5 de la Agrupación son No Adecuados.
SOL MILLENNIUM ESPAÑA	1	1, 3, 4, 5	El lote 2 de la Agrupación es No Adecuado.
VYGON	1	2, 3, 4, 5	El lote 1 de la Agrupación es No Adecuado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA

1. VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica y a las muestras aportadas por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN FUNCIONAL:

NIVEL VALORACION FUNCIONAL
En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- **Calidad del material**: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.
Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.

ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

2.- **Facilidad de utilización**: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.
Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

3**.- Seguridad de resultados**: En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

4**.- Eficacia en el resultado**: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 5 puntos.
Escala de valoración:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
5 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

2 puntos.

ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios No Automáticos basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.
Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará No Adecuada y quedará excluida de la licitación.

En cualquier caso, se considerará No Adecuado:

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas.

- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.

- Aquellos artículos no asociados a los GCs o al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)

- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.

- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

A continuación, se detallan las Empresas y Lotes que **No superan el Umbral Mínimo,** y causas que lo motivan:

EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	1	1, 2, 3, 4, 5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Con sistema de seguridad a la retirada dificultoso, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
TELIC S.A.U.	S.A.	14	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Con fijación poco estable tras su adhesión, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.

VIALTA S.L.	S.A.	14	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Con fijación poco estable tras su adhesión, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
VIALTA S.L.	S.A.	16	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Con fijación poco estable tras su adhesión, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
AMEBIL, S.L.	S.A.	20	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Presenta dificultad para desplegar el catéter y rigidez del mismo, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
IBERIAN CARE 2016 S.L.	S.A.	20	Envoltorio poco resistente. Con

			catéter rígido y poco adaptable, lo que puede producir acodamiento a la inserción, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto a los parámetros objeto de valoración.
ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	S.A.	20	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Presenta dificultad para el montaje de las aletas, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto a los parámetros objeto de valoración.
MBA INCORPORADO S.L.	S.A.	20	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Presenta rigidez del catéter y aletas de sujeción poco ergonómicas, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
VIGON S.A.U.	S.A.	20	Envoltorio muy resistente que

			asegura su apertura garantizando la esterilidad. Las aletas de la aguja se desconectan y dificultan la sujeción, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
MBA INCORPORADO S.L.	S.A.	22	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. El catéter se dobla a la retirada de la aguja, por lo que el resto la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
B.BRAUN MEDICAL, S.A.	S.A.	26	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. De tamaño excesivo, y sin ranura central para facilitar el posicionamiento tras la inserción del catéter, por lo que la oferta cumple las características solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.

ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	S.A.	26	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Sin ranura central para facilitar el posicionamiento tras la inserción del catéter, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.

A continuación, de detallan Empresas y Lotes que, se consideran **No Adecuado** y causas que lo motivan:

EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
B. BRAUN SURGICAL, S.A.	1	2	La referencia ofertada no está asociada al GC y C.SAS objeto de licitación.
SOL MILLENNIUM ESPAÑA	1	2	La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1	4, 5	La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	S.A.	8, 9	La referencia ofertada no está asociada al GC y C.SAS objeto de licitación.

VIGON S.A.U.	1	1	La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS S.L.U.	S.A.	9	La referencia ofertada no está asociada al C.SAS objeto de licitación.
VIGON S.A.U.	S.A.	10	La referencia ofertada no está asociada al C.SAS objeto de licitación.
VIALTA S.L.	S.A.	13, 15	La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
TELIC S.A.U.	S.A.	15	La referencia ofertada no cumple las características técnicas indicadas, presenta unas dimensiones de 50 x 100 mm, que no es lo solicitado.
VIGON S.A.U.	S.A.	22	La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I.

En Jaén, a 11 de Mayo de 2026

D. Alejandro Martínez García. FEA Anestesiología HMQ.

Dña. Leticia García Alemán. Supervisora HMI Jaén.

Dña. Sara Fernández Barranco. Supervisora Quirófano HSA.

Dña. Ana Márquez Sánchez. Jefa Servicio Anestesia y Reanimación del AGS Nordeste, Jaén.

Dña. Miriam Fernández Hornos. Subdirectora Enfermería HSJC.

D. Basilio Velasco Sánchez. FEA Cirugía Pediátrica HMI.

ANEXO I AL C.R.

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09

DE ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

AG	Lotes	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Características	Empresa	Referencia	CIP	Calidad del Material 15-6-0	Facilidad de Utilización 15-6-0	Seguridad de Resultados 15-6-0	Eficacia en el Resultado 5-2-0	Total Puntuación	Pasa el Umbral Mínimo	Observaciones
1	1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 19 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4447047	100115892520	-	-	-	-	-	-	No se valora. Los lotes 2 ,4 y 5 de la Agrupación son No Adecuados.
1	1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 19 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	LH-0034YN	100070151308	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con sistema de seguridad a la retirada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 19 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-2969-24	100169349195	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Con sistema de seguridad a la retirada dificultoso, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
1	1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 19 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	SOL MILLENNIUM ESPAÑA	SHY006	100169506282	-	-	-	-	-	-	No se valora. El lote 2 de la Agrupación es No Adecuado.

ANEXO I AL C.R.

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09

DE ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

1	1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[19-19];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 19 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	VIGON S.A.U.	612511	100138104190	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
1	2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4447051	100115882822	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC y C.SAS objeto de licitación.
1	2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	LH-0031YN	100070159681	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico por el sistema de seguridad a la retirada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-2965-24	100028977893	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Con sistema de seguridad a la retirada dificultoso, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
1	2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	SOL MILLENNIUM ESPAÑA	SHY002	100169506383	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.

1	2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25];	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	VIGON S.A.U.	611709	100169521638	-	-	-	-	-	-	No se valora. El lote 1 de la Agrupación es No Adecuado.
1	3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º.Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4447052	100115892924	-	-	-	-	-	-	No se valora. Los lotes 2, 4 y 5 de la Agrupación son No Adecuados.
1	3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º.Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	LH-0032YN	100070147761	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico por el sistema de seguridad a la retirada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º.Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-2966-24	100028977994	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Con sistema de seguridad a la retirada dificultoso, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
1	3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25];	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º.Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	SOL MILLENNIUM ESPAÑA	SHY003	100169514960	-	-	-	-	-	-	No se valora. El lote 2 de la Agrupación es No Adecuado.

ANEXO I AL C.R.

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09

DE ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

1	3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:[20-30];Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º.Longitud aprox de la aguja 25 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	VIGON S.A.U.	612509	100138103988	-	-	-	-	-	-	No se valora. El lote 1 de la Agrupación es No Adecuado.
1	4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4447055	100115893237	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
1	4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	LH-0029YN	100070147963	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico por el sistema de seguridad a la retirada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-2961-24	100029492694	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Con sistema de seguridad a la retirada dificultoso, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
1	4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	SOL MILLENNIUM ESPAÑA	SHY004	100169515071	-	-	-	-	-	-	No se valora. El lote 2 de la Agrupación es No Adecuado.

1	4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO LATERAL-Diámetro:[22-22];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Hubber con línea de infusión con conector luer y con punto de inyección tipo conector muelle-válvula. Con sistema de seguridad antipinchazos. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Ángulo de 90º. Longitud aprox de la aguja 19 mm, longitud aprox de la línea 20 cm. Dispositivo de extrracción de aguja protegido con almohadilla. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	VIGON S.A.U.	611707	100169521739	-	-	-	-	-	-	No se valora. El lote 1 de la Agrupación es No Adecuado.
1	5	SU.PC.SANI.01.19.01.000006	D92707	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Huber con línea de infusión con conector luer. Con o sin punto de inyección adicional. Con sistema de seguridad antipinchazos. Resistente a flujos elevados de hasta 5ml/seg. Y a una presión max. de 300 psi. Ángulo recto. Longitud aprox aguja de 20mm y longitud aprox de línea de 20 cm. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4447006	100031283897	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
1	5	SU.PC.SANI.01.19.01.000006	D92707	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Huber con línea de infusión con conector luer. Con o sin punto de inyección adicional. Con sistema de seguridad antipinchazos. Resistente a flujos elevados de hasta 5ml/seg. Y a una presión max. de 300 psi. Ángulo recto. Longitud aprox aguja de 20mm y longitud aprox de línea de 20 cm. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	132075	100140075907	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico por el sistema de seguridad a la retirada, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	5	SU.PC.SANI.01.19.01.000006	D92707	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Huber con línea de infusión con conector luer. Con o sin punto de inyección adicional. Con sistema de seguridad antipinchazos. Resistente a flujos elevados de hasta 5ml/seg. Y a una presión max. de 300 psi. Ángulo recto. Longitud aprox aguja de 20mm y longitud aprox de línea de 20 cm. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-3465-24	100015496822	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Con sistema de seguridad a la retirada dificultoso, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
1	5	SU.PC.SANI.01.19.01.000006	D92707	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25);	Aguja tipo Huber con línea de infusión con conector luer. Con o sin punto de inyección adicional. Con sistema de seguridad antipinchazos. Resistente a flujos elevados de hasta 5ml/seg. Y a una presión max. de 300 psi. Ángulo recto. Longitud aprox aguja de 20mm y longitud aprox de línea de 20 cm. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	SOL MILLENNIUM ESPAÑA	SHN002	100169515475	-	-	-	-	-	-	No se valora. El lote 2 de la Agrupación es No Adecuado.

ANEXO I AL C.R.

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09

DE ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

1	5	SU.PC.SANI.01.19.01.000006	D92707	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-Diámetro:[20-20];Longitud aguja:(16-20);Longitud línea:[0-25];	Aguja tipo Huber con línea de infusión con conector luer. Con o sin punto de inyección adicional. Con sistema de seguridad antipinchazos. Resistente a flujos elevados de hasta 5ml/seg. Y a una presión max. de 300 psi. Ángulo recto. Longitud aprox aguja de 20mm y longitud aprox de línea de 20 cm. Material, Cánula de acero inoxidable grado médico. Conector y línea de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure:. la denominación del artículo.. el método de esterilización utilizado.. las fechas de esterilizado y caducidad.. el número de lote.. la referencia comercial.	VIGON S.A.U.	811709	100092917760	-	-	-	-	-	-	No se valora. El lote 1 de la Agrupación es No Adecuado.
S.A.	6	SU.PC.SANI.01.19.00.000003	E88483	AGUJA PUNCION SECA-Long. de la aguja:[50-50];Diámetro de la aguja:[0.30-0.30];	Aguja de punta redonda con mango labrado. Con tubo guia para su introducción Material , Acero quirúrugico. Tubo guia de plástico. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote . La referencia comercial.	No ofertas.	No ofertas.	No ofertas.	-	-	-	-	-	-	No ofertas.
S.A.	7	SU.PC.SANI.01.19.02.000003	E30110	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[6.6-6.6];Diámetro int. cateter:[3-3];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura aprox de cámara de 12mm . catéter de una vía de long aprox de 76 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4430441	100004801701	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con catéter muy flexible y adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	7	SU.PC.SANI.01.19.02.000003	E30110	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[6.6-6.6];Diámetro int. cateter:[3-3];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura aprox de cámara de 12mm . catéter de una vía de long aprox de 76 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-4025-24	100004371455	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con catéter muy flexible y adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	8	SU.PC.SANI.01.19.02.000010	F35364	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[5.7-5.7];Diámetro int. cateter:[3-3];	El equipo consta de:. reservorio subcutáneo de alto perfil con altura de cámara de aprox 15 mm. catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo capaz de soportar presiones de hasta 300 psi., de longitud aprox de 76 cm. conector del cateter al reservorio. aguja portal. tunelizador. sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. las fechas de esterilizado y caducidad. el número de lote. la referencia comercial.	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4433734	100004814732	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC y C.SAS objeto de licitación.
S.A.	8	SU.PC.SANI.01.19.02.000010	F35364	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[5.7-5.7];Diámetro int. cateter:[3-3];	El equipo consta de:. reservorio subcutáneo de alto perfil con altura de cámara de aprox 15 mm. catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo capaz de soportar presiones de hasta 300 psi., de longitud aprox de 76 cm. conector del cateter al reservorio. aguja portal. tunelizador. sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. las fechas de esterilizado y caducidad. el número de lote. la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-4425-24	100022128822	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con catéter muy flexible y adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

ANEXO I AL C.R.

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09

DE ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN


S.A.	9	SU.PC.SANI.01.19.02.000009	B38006	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ BAJO PERFIL / ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11);Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3.9-3.9];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura de la cámara de aprox 10mm . catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo , con longitud aprox de 60 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4436946	100004814136	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC y C.SAS objeto de licitación.
S.A.	9	SU.PC.SANI.01.19.02.000009	B38006	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ BAJO PERFIL / ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11);Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3.9-3.9];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura de la cámara de aprox 10mm . catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo , con longitud aprox de 60 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	8716001 / 8716000	100031286524 / 100166739636	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con catéter muy flexible y adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	9	SU.PC.SANI.01.19.02.000009	B38006	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ BAJO PERFIL / ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11);Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3.9-3.9];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura de la cámara de aprox 10mm . catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo , con longitud aprox de 60 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	CARDIVA 2, S.L.	CT60LTBD RVI	100159717001	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con catéter muy flexible y adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	9	SU.PC.SANI.01.19.02.000009	B38006	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ BAJO PERFIL / ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11);Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3.9-3.9];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura de la cámara de aprox 10mm . catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo , con longitud aprox de 60 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar, tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS S.L.U.	KP6122800	100004815348	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al C.SAS objeto de licitación.
S.A.	10	SU.PC.SANI.01.19.02.200006	E03693	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT. PLASTICO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[8-8];Diámetro int. cateter:[7-7.5);	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo de alto perfil con altura de cámara aprox 12 mm. catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo y longitud aprox de 50 cm. conector del cateter al reservorio. aguja portal. tunelizador. . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de material plástico. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	CARDIVA 2, S.L.	CTKP-008IS-CA	100024734542	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con catéter muy flexible y adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

ANEXO I AL C.R.


SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09

DE ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

S.A.	10	SU.PC.SANI.01.19.02.200006	E03693	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT. PLASTICO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[8-8];Diámetro int. cateter:[7-7.5];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo de alto perfil con altura de cámara aprox 12 mm. catéter de una vía con luz interna muy amplia que permita un alto flujo y longitud aprox de 50 cm. conector del cateter al reservorio. aguja portal. tunelizador. . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de material plástico. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	VIGON S.A.U.	4017 ISP	100092929185	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al C.SAS objeto de licitación.
S.A.	11	SU.PC.SANI.01.19.02.201000	B44001	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT.PLASTICO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[11-20];Diámetro ext. cateter:[6-6];Diámetro int. cateter:[3.9-3.9];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo con altura de cámara aprox de 11 mm . catéter de una vía con longitud aprox de 75 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material,Cámara de material plástico. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizdor metálico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0607530CE	100004331855	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con catéter muy flexible y adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	12	SU.PC.SANI.01.19.02.300003	B43930	EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-Longitud catéter:[50-100];Altura de la cámara:[0-11);Diámetro ext. cateter:[7-7];Diámetro int. cateter:[3.3-3.3];	El equipo consta de: . reservorio subcutáneo de doble cámara con altura aprox de 10 mm . catéter de dos vías con longitud aprox de 75 cm . conector del cateter al reservorio . aguja portal . tunelizador . sistema introductor: aguja, dilatador pelable, guía y con o sin jeringa . Material, Cámara de material plástico y titanio. Catéter de silicona, poliuretano o similar. Tunelizador metálico. Bajo perfil (hasta 10.9mm. de altura del dispositivo). Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. la referencia comercial.	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0604970CE	100004320541	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con catéter muy flexible y adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	13	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C29529	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:(0-5];Ancho:[0-30);	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible: DIGISTIM Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	CARDIVA 2, S.L.	UF2020	100004903337	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con fijación muy estable tras su adhesión, sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	13	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C29529	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:(0-5];Ancho:[0-30);	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible: DIGISTIM Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	VIALTA S.L.	CWN1003	100169370906	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
S.A.	14	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60);Ancho:[30-60);	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible:TENS. Envase unitario Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	TC4848	100079419616	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con fijación muy estable tras su adhesión, sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

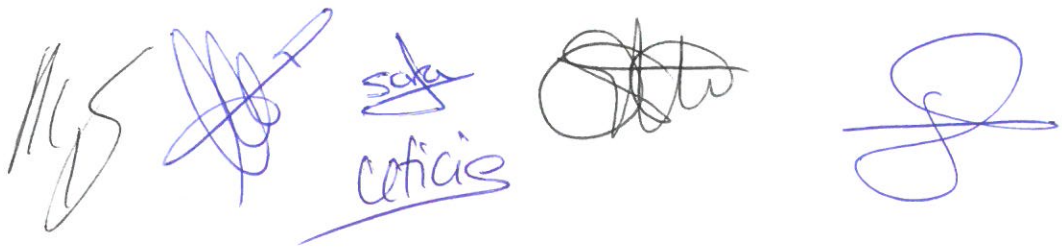

S.A.	14	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible:TENS. Envase unitario Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	TELIC S.A.U.	ST-50	100169455166	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Con fijación poco estable tras su adhesión, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
S.A.	14	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible:TENS. Envase unitario Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	VIALTA S.L.	CWN2505	100169371017	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Con fijación poco estable tras su adhesión, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
S.A.	15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B54770	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[60-90];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible:TENS, NMES Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial	TELIC S.A.U.	ST-100	100169462935	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no cumple las características técnicas indicadas, presenta unas dimensiones de 50 x 100 mm, que no es lo solicitado.
S.A.	15	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B54770	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[60-90];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Eq. compatible:TENS, NMES Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial	VIALTA S.L.	CWN2509	100169371118	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
S.A.	16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Eq. compatible: terminal hembra 2 mm Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	T5090	100079419414	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con fijación muy estable tras su adhesión, sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado
S.A.	16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Con cable incorporado y conector universal hembra. Eq. compatible: terminal hembra 2 mm Material plástico y núcleo de acero inoxidable grado médico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial	VIALTA S.L.	CWN2509	100169371118	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Con fijación poco estable tras su adhesión, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
S.A.	17	SU.PC.SANI.01.19.03.100002	B50955	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR S/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-60];	Electrodo pregelado, moldeable, de baja impedancia. Eq. compatible:terminal hembra 2 mm Material plástico. Envase unitario. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial.	No ofertas	No ofertas	No ofertas	-	-	-	-	-	-	No ofertas.
S.A.	18	SU.PC.SANI.01.19.03.200000	E92096	CATETER BLOQUEO GANGLIO ESFENOPALATINO (GEP)-Diámetro de la cánula externa:[5-5];Longitud de la cánula externa:[85-85];	Equipo que consta de: - Catéter o cánula con marcas radiopacas y marcas de profundidad - Catéter con punta angulada y preformada que se introduce por el otro catéter o cánula. Material plástico Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. . la referencia comercial.	No ofertas	No ofertas	No ofertas	-	-	-	-	-	-	No ofertas.

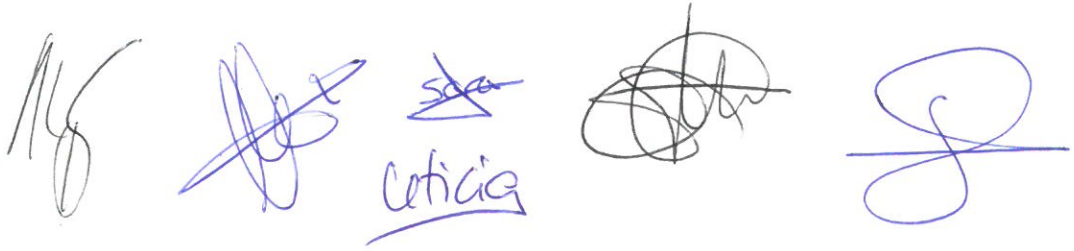

S.A.	19	SU.PC.SANI.01.19.05.000006	C28754	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO / pediátrico-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY pediátrica, de aprox 50 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud,de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4512006C	100014179526	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, tanto al desplegar el catéter como por su flexibilidad y adaptabilidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	20	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	B47386	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	AMEBIL, S.L.	ASE15100 00015131 1101N7	100169475865	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Presenta dificultad para desplegar el catéter y rigidez del mismo, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
S.A.	20	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	B47386	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4514017	100004337118	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, tanto al desplegar el catéter como por su flexibilidad y adaptabilidad, con aletas de sujeción muy ergonómicas, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	20	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	B47386	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	IBERIAN CARE 2016 S.L.	TEPIS1880 3	100154685871	0	0	0	0	0	NO	Envoltorio poco resistente. Con catéter rígido y poco adaptable, lo que puede producir acodamiento a la inserción, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto a los parámetros objeto de valoración.
S.A.	20	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	B47386	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	100/391/ 118	100169508202	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Presenta dificultad para el montaje de las aletas, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto a los parámetros objeto de valoración.

S.A.	20	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	B47386	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	MBA INCORPORADO S.L.	EK18080BL	100149922961	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Presenta rigidez del catéter y aletas de sujeción poco ergonómicas, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
S.A.	20	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	B47386	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	VIGON S.A.U.	51913871	100084079485	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Las aletas de la aguja se desconectan y dificultan la sujeción, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
S.A.	21	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	D88210	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3.8-3.8];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[18-18];Filtro:si;	El equipo consta de: - aguja espinal con punta TOUHY, de aprox 80 mm. - catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 91 cm. - filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - adaptador. - con jeringa de baja resistencia. Material, Catéter silicona o similar. Aguja de acero inoxidable grado médico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	100/391/128	100169508101	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, facilmente insertable a través de la aguja, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	22	SU.PC.SANI.01.19.05.090000	C24987	EQ. ANESTESIA LOCO-REGIONAL COMBINADO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[27-27];Filtro:si;	El equipo consta de: - 2 agujas: 1 tipo touhy y 1 punta lapiz o bisel romo de aprox 125 mm. - 1 catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - 1 filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - 1 adaptador. - 1 jeringa de baja resistencia. Material, Aguja de acero inoxidable grado médico. Catéter de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. la referencia comercial.	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4556674	100004359433	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, tanto en su inserción como a la retirada de la aguja, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	22	SU.PC.SANI.01.19.05.090000	C24987	EQ. ANESTESIA LOCO-REGIONAL COMBINADO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[27-27];Filtro:si;	El equipo consta de: - 2 agujas: 1 tipo touhy y 1 punta lapiz o bisel romo de aprox 125 mm. - 1 catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - 1 filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - 1 adaptador. - 1 jeringa de baja resistencia. Material, Aguja de acero inoxidable grado médico. Catéter de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. la referencia comercial.	MBA INCORPORADO S.L.	CSE1827BL	100165923593	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. El catéter se dobla a la retirada de la aguja, por lo que el resto la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.

S.A.	22	SU.PC.SANI.01.19.05.090000	C24987	EQ. ANESTESIA LOCO-REGIONAL COMBINADO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de filtro:plano;Diámetro aguja:[27-27];Filtro:si;	El equipo consta de: - 2 agujas: 1 tipo touhy y 1 punta lapiz o bisel romo de aprox 125 mm. - 1 catéter radiopaco con marcas de longitud, de aprox 100 cm. - 1 filtro antibacteriano con poros para filtrado de 0,2 micras. - 1 adaptador. - 1 jeringa de baja resistencia. Material, Aguja de acero inoxidable grado médico. Catéter de material plástico. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote. la referencia comercial.	VIGON S.A.U.	6186042	100015529663	-	-	-	-	-	-	No Adecuado. La referencia ofertada no está asociada al GC objeto de licitación.
2	23	SU.PC.SANI.01.19.03.002000		ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH-Capacidad reservorio:[2-2]	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantice el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario, Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	CARDIVA 2, S.L.	199334-001	100004329935	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con fijación muy estable tras su adhesión, sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado
2	24	SU.PC.SANI.01.19.03.002000		ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH-Capacidad reservorio:[2.5-2.5];	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantice el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario, Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	CARDIVA 2, S.L.	199335-001	100004329834	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con fijación muy estable tras su adhesión, sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado
2	25	SU.PC.SANI.01.19.03.002000		ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH-Capacidad reservorio:[4-4];	Dispositivo circular con conexión a la red y a fluidos. Con sistema buffer con una sustancia química que sirve para equilibrar el pH. Con una capa dispersiva que garantice el contacto uniforme de la medicación y una capa conductora que distribuya la corriente por igual por la zona activa. Material plástico y núcleo de acero inoxidable de grado médico. Envase unitario, Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el número de lote. . la referencia comercial.	CARDIVA 2, S.L.	199336-001	100004329733	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con fijación muy estable tras su adhesión, sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado
S.A.	26	SU.PC.SANI.01.19.05.400000	B43706	SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC	Dispositivo con adhesivo para fijación en la piel. Sistema de fijación del catéter mediante presión o adhesivo. Diversos materiales. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4511200	100071073119	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. De tamaño excesivo, y sin ranura central para facilitar el posicionamiento tras la inserción del catéter, por lo que la oferta cumple las características solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
S.A.	26	SU.PC.SANI.01.19.05.400000	B43706	SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC	Dispositivo con adhesivo para fijación en la piel. Sistema de fijación del catéter mediante presión o adhesivo. Diversos materiales. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	100/399/218	100011965562	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Sin ranura central para facilitar el posicionamiento tras la inserción del catéter, por lo que la oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al resto de parámetros objeto de valoración.
S.A.	26	SU.PC.SANI.01.19.05.400000	B43706	SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC	Dispositivo con adhesivo para fijación en la piel. Sistema de fijación del catéter mediante presión o adhesivo. Diversos materiales. Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	ME8170	100024372283	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con ranura central para facilitar su posicionamiento tras la inserción del catéter, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.



ANEXO I AL C.R.

SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.09

DE ANALGESIA Y ANESTESIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

S.A.	27	SU.PC.SANI.01.19.05.700000	F18055	PRODUCTOS PARA CRIOANESTESIA LOCAL-GC	Producto en solución para pulverización sobre piel intacta con el que se consigue un fuerte descenso de la temperatura que proporciona una anestesia local en la zona. Material Cloretilo Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. el método de esterilización utilizado . las fechas de esterilizado y caducidad . el número de lote . la referencia comercial.	No ofertas	No ofertas	No ofertas	-	-	-	-	-	-	No ofertas.

AG	Lotes	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	Empresa	Referencia	CIP	Pasa el Umbral Mínimo (25 puntos)	Precio Ofertado S/Iva (Sobre Nº 3)	Precio Ofertado C/Iva (Sobre Nº 3)	Criterios Automáticos 50 Puntos = Mejor oferta Económica Resto: Punt. Max x importe mejor oferta/ importe oferta objeto	Total Puntuación	EMPRESA PROPUESTA ADJUDICATARIA	OFERTA ANORMAL+ BAJA	
1	1	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	B76500	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO	BECTON DICKINSON, S.A.U.	LH-0034YN	100070151308	SI	2,7990 €	3,386790 €	50	100	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0,74047619	
1	2	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D85326	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO	BECTON DICKINSON, S.A.U.	LH-0031YN	100070159681	SI	2,7990 €	3,386790 €	50	100	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0,74047619	
1	3	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92272	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO	BECTON DICKINSON, S.A.U.	LH-0032YN	100070147761	SI	2,7990 €	3,386790 €	50	100	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0,74047619	
1	4	SU.PC.SANI.01.19.01.000004	D92274	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD, LINEA Y ACCESO	BECTON DICKINSON, S.A.U.	LH-0029YN	100070147963	SI	2,7990 €	3,386790 €	50	100	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0,74047619	
1	5	SU.PC.SANI.01.19.01.000006	D92707	AGUJA PORTAL VENOSO ACODADA C/ SIST. SEGURIDAD Y LINEA /ALTO FLUJO-	BECTON DICKINSON, S.A.U.	132075	100140075907	SI	2,9900 €	3,617900 €	50	100	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0,74009901	
S.A.	7	SU.PC.SANI.01.19.02.000003	E30110	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	4430441	100004801701	SI	120,0000 €	132,0000 €	50	100	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	0,827586207	
S.A.	7	SU.PC.SANI.01.19.02.000003	E30110	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL-Longitud catéter:[50-	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-4025-24	100004371455	SI	140,0000 €	154,0000 €	43	93	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	0,965517241	
S.A.	8	SU.PC.SANI.01.19.02.000010	F35364	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO-Longitud	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	21-4425-24	100022128822	SI	140,0000 €	154,0000 €	50	100	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	0,965517241	
S.A.	9	SU.PC.SANI.01.19.02.000009	B38006	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ BAJO PERFIL / ALTO FLUJO-Longitud	BECTON DICKINSON, S.A.U.	8716001 / 8716000	100031286524 / 100166739636	SI	250,0000 €	275,000000 €	42	92	BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	
S.A.	9	SU.PC.SANI.01.19.02.000009	B38006	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA TITANIO/ BAJO PERFIL / ALTO FLUJO-Longitud	CARDIVA 2, S.L.	CT60LTBDRVI	100159717001	SI	210,0000 €	231,0000 €	50	100	CARDIVA 2, S.L.	0,84	
S.A.	10	SU.PC.SANI.01.19.02.200006	E03693	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT. PLASTICO/ ALTO PERFIL/ ALTO FLUJO-	CARDIVA 2, S.L.	CTKP-008IS-CA	100024734542	SI	146,1800 €	160,7880 €	50	100	CARDIVA 2, S.L.	0,730854545	
S.A.	11	SU.PC.SANI.01.19.02.201000	B44001	EQ. PORTAL VASCULAR CAMARA MAT.PLASTICO/ ALTO PERFIL-Longitud	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0607530CE	100004331855	SI	215,0000 €	236,500000 €	50	100	BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	
S.A.	12	SU.PC.SANI.01.19.02.300003	B43930	EQ. PORTAL VASCULAR DOBLE CAMARA M.PLASTICO Y TITANIO/ BAJO PERFIL-	BECTON DICKINSON, S.A.U.	0604970CE	100004320541	SI	415,0000 €	456,500000 €	50	100	BECTON DICKINSON, S.A.U.	1	
S.A.	13	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C29529	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:(0-5];Ancho:[0-30);	CARDIVA 2, S.L.	UF2020	100004903337	SI	1,3000 €	1,5730 €		50	CARDIVA 2, S.L.	0,977473371	
S.A.	14	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	B51447	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[30-60);Ancho:[30-	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	TC4848	100079419616	SI	0,29300 €	0,35453 €		50	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	0,901561387	
S.A.	16	SU.PC.SANI.01.19.03.103000	C28741	ELECTRODO ADHESIVO PARA ESTIMULADOR C/ CABLE-Longitud:[90-120];Ancho:[30-	INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.	T5090	100079419414	SI	0,41000 €	0,49610 €		50	OFERTA ANORMALMENTE BAJA	0,369000122	0,63099988
S.A.	19	SU.PC.SANI.01.19.05.000006	C28754	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO / pediátrico-Diámetro catéter:[3-	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4512006C	100014179526	SI	39,85 €	48,2185 €		50	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	0,998746867	
S.A.	20	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	B47386	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4514017	100004337118	SI	10,99 €	13,2979 €		50	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	0,999090909	
S.A.	21	SU.PC.SANI.01.19.05.000004	D88210	EQ. ANESTESIA EPIDURAL 1 AG. PUNTA BISEL ROMO-Diámetro catéter:[3.8-	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	100/391/128	100169508101	SI	5,5000 €	6,6600 €		50	ICU MEDICAL Prod. Farmac. y Hospit S.L	1,000751315	
S.A.	22	SU.PC.SANI.01.19.05.090000	C24987	EQ. ANESTESIA LOCO-REGIONAL COMBINADO-Diámetro catéter:[3-3];Tipo de	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4556674	100004359433	SI	32,99 €	39,9179 €		50	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	0,99969697	
2	23	SU.PC.SANI.01.19.03.002000		ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH-Capacidad reservorio:[2-2]	CARDIVA 2, S.L.	199334-001	100004329935	SI	5,60 €	6,776 €		50	CARDIVA 2, S.L.	0,952380952	

2	24	SU.PC.SANI.01.19.03.002000		ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH- Capacidad reservorio:[2.5-	**CARDIVA 2, S.L.**	199335-001	100004329834	SI	5,60 €	6,776 €		50	**CARDIVA 2, S.L.**	0,965517241	
2	25	SU.PC.SANI.01.19.03.002000		ELECTRODO IONTOFORESIS CON CONTROL DE PH- Capacidad reservorio:[4-4];	**CARDIVA 2, S.L.**	199336-001	100004329733	SI	5,60 €	6,776 €		50	**CARDIVA 2, S.L.**	0,952381086	
S.A.	26	SU.PC.SANI.01.19.05.400000	B43706	SISTEMA FIJACION CATETER EPIDURAL - GC	**INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.**	ME8170	100024372283	SI	2,22000 €	2,68620 €		50	**INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.**	0,934362934	